

Kullanım kılavuzu



BTE SP
BTE UP

Oticon Xceed
Oticon Xceed Play

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Modele genel bakış

Bu kitapçık, aşağıdaki işitme cihazı modellerinde Oticon Xceed ve Xceed Play aileleri için geçerlidir:

- BTE SP (Pil boyutu 13)
- BTE UP (Pil boyutu 675)

FW 8

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon Xceed 1 | GTIN: (01) 05707131357571 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Xceed 2 | GTIN: (01) 05707131357564 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Xceed 3 | GTIN: (01) 05707131357557 |

FW 8

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oticon Xceed Play 1 | GTIN: (01) 05707131357540 |
| <input type="checkbox"/> Oticon Xceed Play 2 | GTIN: (01) 05707131357533 |

- Görsel gösterim için LED ışık. Bakıcıların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin işitme cihazını kullanmalarına yardımcı olmak ve ilgili işlemlere ve modlara ilişkin talimatlar sunmak için kullanılır (bu kitapçıktaki ilgili bilgilere bakın).

Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni işitme cihazınızın kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. Lütfen **Uyarılar** bölümünü dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu, yeni işitme cihazınızdan tam olarak yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınıza danışın.

| **Hakkında** | Başlangıç | Kullanım | Seçenekler | Tinnitus | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Bu işitme cihazı, sesi yükseltmek, kulağa iletmek, dolayısıyla orta, ileri ve çok ileri derecede işitme kaybını telafi etmek için tasarlanmıştır. İşitme cihazı, yetişkinler, çocuklar ve bebekler tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ UYARI


Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında işitme uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme yeteneğinize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

İçindekiler tablosu

Hakkında	
İşitme cihazının parçaları ve işlevleri	8
Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın	10
Temizleme ve pilleri tutmak için Çok Amaçlı Alet	11
Başlangıç	
İşitme cihazını AÇIN ve KAPATIN	12
Pilin değiştirilme zamanı	13
Pil değiştirme	14
Kullanım	
İşitme cihazını takın	16
İşitme cihazının bakımı	17
Uçak modu	20
Seçenekler	
İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar	21
Programı değiştirme	22
Ses seviyesini değiştirme	23
Sessiz	24
İşitme cihazını iPhone ve iPad ile kullanma	25
iPhone ile eşleştirme	26

Kablosuz aksesuarlar	28
Diğer seçenekler	30
Kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası	32
Tinnitus	
Tinnitus SoundSupport™ (opsiyonel)	34
Tinnitus ses üreticisi kullanıcıları için yönergeler	35
Ses ve ses seviyesi ayarı	36
Kullanım süresi sınırlaması	39
Uyarılar	
Tinnitus SoundSupport uyarıları	42
Genel uyarılar	43
Ek bilgiler	
Sorun Giderme	48
Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)	50
Kullanım koşulları	51
Teknik bilgi	52
Garanti	57
Kişisel işitme cihazı ayarlarınız	58
Ses ve LED göstergeler	60

İşitme cihazının parçaları ve işlevleri

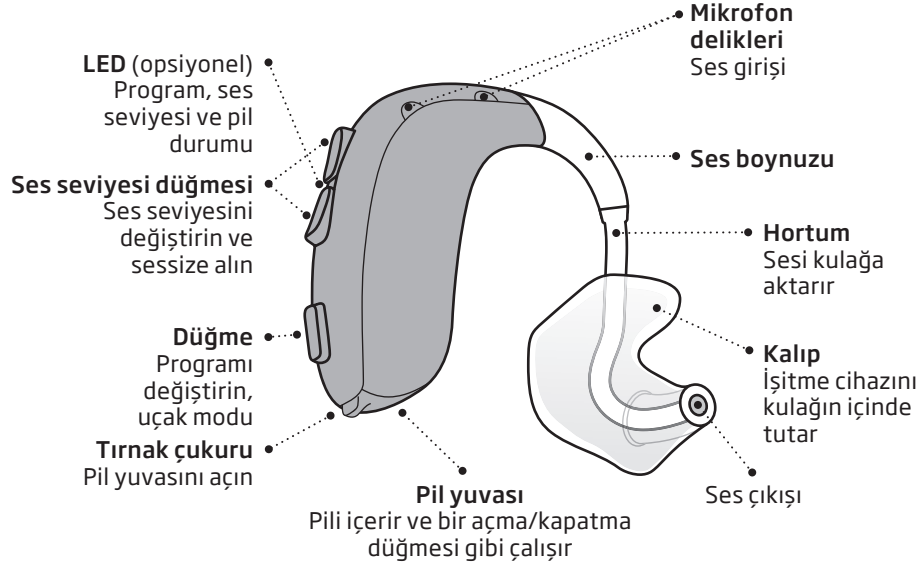


BTE SP ve BTE UP modellerinin kullanımı aynıdır. Bu nedenle, bu kitapçıkta görseller sadece BTE SP'ı göstermektedir.

Sol ve sađ iřitme cihazını tanımlayın

Farklı programlanmış olabileceğinden, sol ve sađ iřitme cihazı arasında ayırım yapmak önemlidir.


Sol/sađ renk göstergelerini pil yuvasında bulabilirsiniz. Göstergeler kalıplarda da bulunabilir.



- **MAVİ** gösterge, SOL iřitme cihazını iřaretler
- **KIRMIZI** gösterge, SAĐ iřitme cihazını iřaretler

Temizleme ve pilleri tutmak için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, iřitme cihazındaki pilin deęiřtirilmesini kolaylařtıran bir mıknatıs ierir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fıra ve tel dngü de ierir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen iřitme uzmanınızla irtibata gein.

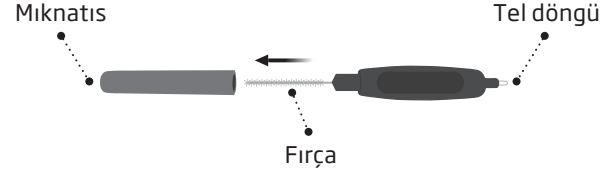

ÖNEMLİ UYARI

Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diđer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutun.

İşitme cihazını AÇIN ve KAPATIN

Pil yuvası işitme cihazını AÇIP KAPATMAK için kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızın KAPALI olduğundan emin olun. İşitme cihazını AÇIK konuma getirdiğinizde, bir açılış müziği çalacaktır. KAPALI konuma getirdiğinizde, azalan dört ton sesi çalacaktır.


Cihazın standart ayarlarına dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatmanız yeterli olur.

Opsiyonel LED

İki defa yeşil renkte uzun yanıp sönme, işitme cihazının çalıştığını gösterir.


AÇIN

Pili yerleştirip pil yuvasını kapatın.




KAPATIN

Pil yuvasını açın.



Pilin değiştirilme zamanı

Pilin değiştirilme zamanı geldiğinde, pil bitene kadar hafif aralıklarla art arda üç ton sesi duyacaksınız.

 Art arda üç ton sesi*
= Pil zayıflıyor

 Azalan dört ton sesi
= Pil bitti

Pille ilgili ipucu

İşitme cihazınızın her zaman çalışır durumda kalmasını sağlamak için her zaman yanınızda yedek bir pil bulundurun.


İsteğe bağlı LED

Sürekli turuncu yanıp sönme pilin zayıfladığını gösterir.

* Bluetooth® kapanacak ve kablosuz aksesuarlar kullanılamayacaktır.
Not: İşitme cihazınıza ses akışı yapıyorsanız, pillerin daha sık değiştirilmesi gerekir.

Pil deęiřtirme

1. ıkart



Pil yuvasını tam açın.
Pili ıkartın.


2. Band'tan ayır



Yeni pilin + işaretinin
olduęu taraftaki
yapışkan bandı pilden
ayırın.

İpucu:
Pilin hava alması ve en
iyi şekilde çalışmasını
saęlamak için 2 dakika
bekleyin.


3. Yerleřtir



Yeni pili pil yuvasına
yerleřtirin. + tarafın
yukarıya dönük oldu-
ğundan emin olun.

Onu üstten takın,
yandan DEęİL.

4. Kapat



Pil yuvasını kapatın. İřitme cihazı,
kulaklıktan bir açılıř müzięi alar.

Açılıř müzięini duymak için kulaklıęı
kulaęınızın yakınına tutun.

İpucu




ok Amaçlı Alet

ok Amaçlı alet, pilleri ıkartmak ve
takmak için kullanılabilir. Pillerini
ıkartmak ve takmak için manyetik
ucu kullanın.

ok Amaçlı Alet, iřitme uzmanınız
tarafından saęlanır.

İşitme cihazını takın



Kalıp, sizin için özelleştirilmiştir ve kulağınızın şekline tam oturur. Kalıplar, benzersiz bir şekilde sol veya sağ kulak içindir.

Adım 1



Hafifçe kulağınızı dışa doğru çekin ve kulak kalıbını hafif bükerek kulak kanalınız yönünde bastırın.

Adım 2




İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştirin.

İşitme cihazının bakımı

İşitme cihazınızın düşmesi durumunda zarar görmesini önlemek için bakımını yumuşak bir zemin üzerinde yapın.

Mikrofon deliklerini temizleyin

Deliklerdeki kalıntıları dikkatli bir şekilde fırçalamak için Çok Amaçlı Aletin fırçasını kullanın. Deliklerin etrafındaki yüzeyi dikkatli bir şekilde fırçalayın.

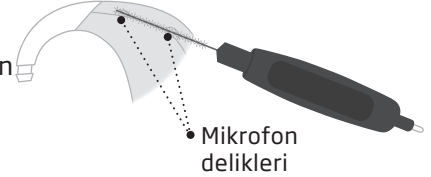


Kuvvet uygulanmasından dolayı Çok Amaçlı Aletin hiçbir parçasının mikrofon deliklerine sıkışmadığından emin olun. Bu, işitme cihazında hasara neden olabilir.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. İşitme cihazı asla su veya başka bir sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Kalıbı temizleyin

Kalıp düzenli olarak temizlenmelidir. Yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Deliği temizlemek için Çok Amaçlı Aletin tel döngüsünü kullanın.

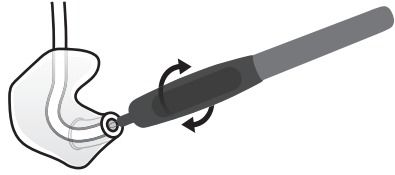

Hortumu değiştirin

Kalıpla işitme cihazı arasındaki hortum sararınca veya sertleşince değiştirilmelidir. Bununla ilgili olarak, işitme uzmanınıza danışın.

Kalıbı yıkayın

Adım 1




İşitme cihazından sökmeden önce, hangi kalıbın hangi işitme cihazı için olduğunu tanımlayabileceğinizden emin olun.

Adım 2



Hortumu ve kalıbı cihazın boynuzundan ayırın. Hortumu çekerken boynuzu sıkı tutun. Aksi takdirde işitme cihazı hasar görebilir.

Adım 3




Kalıbı ve hortumu yumuşak sabun kullanarak yıkayın. İşitme cihazına tekrar takmadan önce durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Uçak modu

Uçak modu etkinleştirildiğinde Bluetooth® kapanır. İşitme cihazı çalışmaya devam edecektir. İşitme cihazlarının biri üzerindeki dokunmatik düğmeye basıldığında, her iki işitme cihazında da uçak modu etkinleştirilecektir.

Opsiyonel LED

Uçuş modu etkinleştirildiğinde, LED sürekli yeşil, turuncu ve turuncu renkte yanıp söner.



- **Etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için**
Düğmeye en az yedi saniye süreyle basın.
Kısa bir müzik sesi, bu eyleminizi doğrular.

Pil yuvasını açıp kapatmak, uçak modunu da devre dışı bırakır. Kısa bir müzik sesi, bu eyleminizi doğrular.

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda açıklanan özellik ve aksesuarlar isteğe bağlıdır. Özellikler ve aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Zor dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.


Yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz işitme koşullarını aşağıda belirtin.

Programı deęiřtirme

İřitme cihazınıza en fazla drt farklı program yklenebilir. Programı deęiřtirdięinizde, ilgili programa baęlı olarak bir ile drt ton sesi duyacaksınız.

Opsiyonel LED

Yeřil renkte yanıp snme sayısı seilen programı gsterir.



- Programlar arasında geiř yapmak iin dokunmatik dğmeye basın.


Program dngs bir programdan dięerine geer, rneęin program 1'den 2'ye veya program 4'ten 1'e.

Ses seviyesini deęiřtirme

Ses seviyesi dğmesi, sesi ayarlamanızı saęlar. Sesi ykselttięinizde ya da azaltdięinizde bir uyarı sesi duyulur.

İsteęe baęlı LED

Yeřil renkte yanıp snme ses seviyesi deęiřiklięini doęrular. Yeřil renkte uzun yanıp snme aılıř ses seviyesine ulařıldięını gsterir. Minimum veya maksimum seviyeye ulařtdięinizde turuncu renkte yanıp snecektir.



- Ses seviyesini ykseltmek iin dğmeye basın
- Ses seviyesini azaltmak iin dğmeye basın




Sessiz

İşitme cihazı takılıyken, sesi geçici olarak kapatmanız gerektiğinde, sessiz işlevini kullanın. Sessiz işlevi yalnızca işitme cihazlarındaki mikrofonları sessize alır.

Opsiyonel LED

Sürekli turuncu ve yeşil yanıp sönme sessizde olduğunu gösterir.



İşitme cihazını sessize alma

Ses seviyesi düğmesinin herhangi bir tarafına en az dört saniye basın.

Tekrar etkinleştirmek için düğmenin herhangi bir tarafına kısa süreyle basın.

ÖNEMLİ UYARI

Sessiz konumda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi işitme cihazınızı kapatmak için kullanmayın.

İşitme cihazını iPhone ve iPad ile kullanma

İşitme cihazınız iPhone® için üretilmiştir ve iPhone, iPad® veya iPod touch® ile doğrudan iletişim ve kontrole izin verir. Bu ürünleri işitme cihazınızla kullanma konusunda yardım almak için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.




Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin.

Made for Apple işaretinin kullanımı, bir aksesuarın özellikle bu işaretle tanımlanan Apple ürün(ler) ile bağlantı kurması için tasarlandığı ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşılayacak şekilde sertifikalandırıldığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygun olmasından sorumlu değildir.

Lütfen bu Aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının, kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğini unutmayın.


iPhone ile eşleştirme

1. Ayarlar

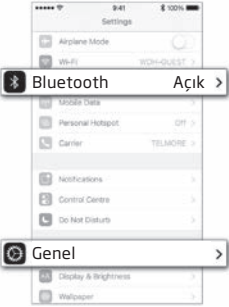


iPhone'unuzu açın ve "Ayarlar" bölümüne gidin. Bluetooth açık olduğundan emin olun. Ardından "Genel" seçeneğini seçin.

2. Genel

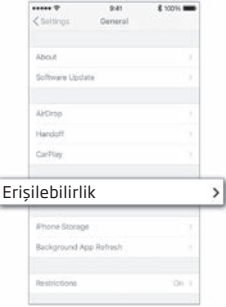


"Genel" ekranından "Erişilebilirlik" seçeneğini seçin.

3. Erişilebilirlik

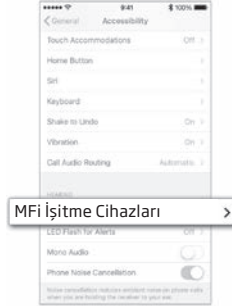


"Erişilebilirlik" ekranından "MFi İşitme Cihazlarını" seçin.

4. Hazırla

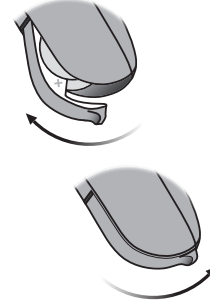


Her iki işitme cihazı-nızdaki pil yuvasını da açın ve kapatın ve onları iPhone'unuzun yakınına getirin. İşitme cihazları 3 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır.

5. Seç

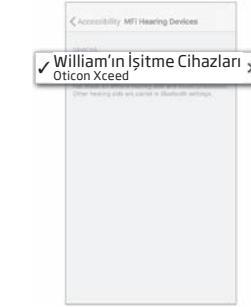

iPhone, eşleşme için işitme cihazlarını algılar. Algılanan cihazlar, iPhone listenizde görünür. İşitme cihazlarınızı seçin.

6. Eşleşmeyi onayla

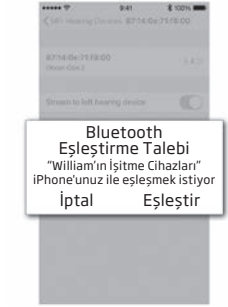

Eşleştirmeyi onaylayın. İki işitme cihazınız varsa, her işitme cihazı için eşleştirme onayı gerekir.

Kablosuz aksesuarlar

Kablosuz işitme cihazlarınızı geliştirmek için birçok aksesuar kullanılabilir. Bunlar, günlük durumların birçoğunda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

ConnectClip

ConnectClip ile eşleştirildiğinde, işitme cihazlarınız eller serbest mikrofonlu kulaklık olarak kullanılabilir. ConnectClip ayrıca uzak mikrofon olarakta kullanılabilir.

TV Adaptörü 3.0

Doğrudan TV veya bir elektronik ses aygıtından işitme cihazınıza ses akışı sağlar.

Telefon Adaptörü 2.0

ConnectClip aracılığıyla işitme cihazlarınıza kablosuz olarak bağlanarak, sabit telefon kullanımına olanak sağlar.

Uzaktan Kumanda 3.0

İşitme cihazınızdaki programı değiştirme veya sesi ayarlama veya sessize getirme özelliği sunar.

Oticon ON App

İşitme cihazlarınızı kontrol etmenin sezgisel ve gizli bir yolu. iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ cihazlar için.

Daha fazla bilgi için www.oticon.global adresini ziyaret edin veya işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Diğer seçenekler



Telecoil programı

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya sinema/tyatro, kilise veya seminer salonları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olur. Teleloop kurulumu bu simge veya benzer bir işaretle gösterilir.

Doğrudan Ses Girişi (DAI)

İşitme cihazınızın doğrudan televizyon, radyo, müzik çalar vs. gibi harici kaynaklardan sinyal almasına izin verir. DAI adaptörü, işitme cihazınıza monte edilir ve bir kabloyla harici bir ses kaynağına bağlıdır. DAI adaptörünü takmak için İşitme Uzmanınızın pil yuvasını değiştirmesi gerekir.

ÖNEMLİ UYARI

Prize takılı bir ses kaynağına DAI pabucu ile bağlanıldığında, bu ses kaynağı IEC 62368 veya eşdeğer güvenlik standartları ile uyumlu olmalıdır.

FM

Atanmış bir vericiden gelen konuşma veya ses sinyallerini doğrudan işitme cihazınıza almanızı sağlar. Bir FM alıcı veya FM adaptörünü takabilmek için İşitme Uzmanınızın pil yuvasını değiştirmesi gerekir.

CROS

Bir kulağında tedavi edilemez işitme kaybı bulunan kişiler için çözüm. Daha zayıf olan kulaktaki bir verici daha iyi durumda olan kulaktaki bir işitme cihazına sesi aktarır.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası


Pili, bebeklerin, küçük çocukların veya öğrenme engelli kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklamak için kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI

Kilitli konumdayken pil yuvasını açmak için aşırı güç kullanmaktan kaçının. Tam olarak açılmış olan pil yuvasını daha fazla açmak için zorlamayın. Pili doğru taktığınızdan emin olun.


Kurcalanmaya karşı dayanıklılığın etkinliğinden veya kilitleme özelliğinin hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Pil yuvasını kilitleyin




Pil kapağını tamamen kapatın ve kilitli olduğundan emin olun.

Pil yuvasını açma aleti



İşitme uzmanınız tarafından sağlanan bu küçük aleti kullanın.

Pil yuvasının kilidini açın



Aletin ucunu, pil yuvasının arkasındaki küçük deliğe sokun.

1. Sağa doğru hareket ettirin ve tutun.
2. Pil yuvasını açın.

Tinnitus SoundSupport™ (opsiyonel)

Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı

Tinnitus SoundSupport, tinnitus yönetim programının bir birimi olarak, tinnitus şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sağlamak amacıyla ses üreten bir araçtır.

Hedef nüfus, yetişkin (18 yaşından büyük) nüfustur.

Tinnitus SoundSupport, tinnitus ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna hakim yetkili işitme uzmanlarına (odyolog, odyometrist, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tinnitus ses üreticisi kullanıcıları için yönergeler

Bu yönergeler, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunluk ve bant genişliğinde ses üretmek için tasarlanan bir tinnitus yönetim aygıtıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun bir bakım takibi önerebilir. Bu bakımla ilgili öneri ve talimatlara uyulması önemlidir.

Sadece reçeteli olarak kullanın

Sağlıklı bir uygulama için tinnitus bildiren kişinin ses üreticisi kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, tinnitusa neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses üreticisi kullanılmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Ses ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve tinnitus rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. Tercih ettiğiniz ses(ler)i işitme uzmanınızla birlikte seçebilirsiniz.

Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses üreticisi maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

Sessiz

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, Sessiz işlevselliği sadece çevre seslerini sessize alıp, Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. Bakın bölüm: Sessiz.

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir işitme cihazını seçtiğinizde, işitme uzmanınız işitme cihazınızdaki dokunmatik düğmeyi sadece tinnitus rahatlatma sesinin ses seviyesini kontrol etmeniz için ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses üreticisinin ses seviyesi kontrolünü bu iki seçenekten birini kullanarak ayarlar:

A) Her bir kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı ayrı deęiřtir

Ses seviyesi istedięiniz seviyeye gelene kadar(sadece iřitme cihazın birinde) sesi **yükseltmek** için dokunmatik düęmenin üst kısmına art arda basın.

Ses seviyesi istedięiniz seviyeye gelene kadar(sadece iřitme cihazın birinde) sesi **azaltmak** için dokunmatik düęmenin alt kısmına art arda basın.

B) Her iki kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini aynı anda deęiřtir

Her iki iřitme cihazındaki sesi yükseltmek/azaltmak için iřitme cihazlarının birini kullanabilirsiniz. İřitme cihazlarının birinde ses seviyesini deęiřtirdięinizde, dięer iřitme cihazındaki ses seviyesi de bunu takip eder.

Sesi **yükseltmek** için dokunmatik düęmenin üst kısmına art arda kısa süreli basın.

Sesi **azaltmak** için dokunmatik düęmenin alt kısmına art arda kısa süreli basın.

Kullanım süresi sınırlaması

Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı iřitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İřitme uzmanınız, sizin için günlük maksimum Tinnitus SoundSupport kullanım süresi önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İřitme cihazlarındaki rahatlatıcı sesi günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceęinizi öğrenmek için bu kitapçıęın sonundaki "Kişisel iřitme cihazı ayarlarınız" bölümünde "Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması" tablosuna bakın.

İşitme uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

Aygıt açıklaması

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı, 80 dB(A) SPL değerini aştığında, uygulama yazılımı otomatik olarak bir uyarı gösterir. Uygulama yazılımındaki tinnitus uygulama grafiğinin yanındaki "Maks. kullanım süresi göstergesine" bakın.

Ses seviyesi kontrolü devre dışı

İşitme cihazındaki ses üreticisinin ses seviyesi kontrolü varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiyse

"Düğmeler ve Göstergeler" ekranında tinnitus ses seviyesi kontrolünü etkinleştirirseniz, bir uyarı görüntülenebilir. Rahatlatıcı sesin, işitme hasarına neden olabilecek seviyelerde dinlenebilmesi durumunda, bu uyarı meydana çıkar. Uygulama yazılımındaki "Maks. kullanım süresi" tablosunda, hastanın Tinnitus SoundSupport'u güvenli bir şekilde kaç saat kullanabileceği gösterilmektedir.

- Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği her bir program için maks. kullanım süresini not alın.
- Bu değerleri bu kitapçığın arkasındaki "Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması" tablosuna yazın.
- Hastanıza buna göre bilgi verin.

⚠️ Tinnitus SoundSupport uyarıları

İşitme Uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses üreticisini etkinleştirdiyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Bir tinnitus yönetim aygıtıyla üretilen herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, tinnitusun kötüleşme potansiyeli ve/veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya tinnitus da bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktor, odyologa veya diğer işitme uzmanlarına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses üreticisi özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bazı etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanım süresi

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyun. Bu sürenin aşılması, tinnitusun veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

⚠️ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğinizin amacıyla ve doğru kullanımdan emin olmak için işitme cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyurunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorunu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayın. Ayrıca çoğu durumda bir işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının cihazın tüm avantajlarından yararlanamayacağını unutmayın.

İşitme cihazınızla beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın.

İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

Boğulma tehlikesi ve pilleri veya diğer küçük parçaların yutulma riski vardır İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler. Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.

İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla kullanılması önerilir.

36 aylıktan küçük çocukların her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanması gerekir. Lütfen bu seçeneğin kullanılabilirliği konusunda işitme uzmanınızla konuşun.

Pil veya işitme cihazı yutulduğunda acil olarak bir doktora görünün.

Devamı arka sayfada

⚠ Genel uyarılar

Pil kullanımı

Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin patlama riski vardır.

Patlayıcılar

İşitme cihazı güvenlik testine tabi tutulmuş ve normal kullanım koşulları altında kullanıldığında güvenli olduğu tespit edilmiştir.

İşitme cihazı, patlayıcı ortamlar açısından uluslararası standartlara uygunluk konusunda test edilmemiştir. Bu yüzden, 675 pil bulunan işitme cihazlarının potansiyel patlama riskinin söz konusu olduğu alanlarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Bozukluk

İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin pilleri tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkanıldığında işitme cihazları çalışmayabilir.

Aktif implantlar

Bu işitme cihazı, insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimlere insanların maruz kalmasıyla ilgili uluslararası standartlara (Özgül Emilim Oranı - SAR) göre insan sağlığı için geniş kapsamlı olarak test edilmiş ve karakterize edilmiştir.

Maruz kalma değerleri, insan sağlığı ve kalp pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal implantlarla bir arada olma standartlarında tanımlanan insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler için uluslararası kabul edilen SAR güvenlik sınırlarının çok altındadır.

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

Dahili bir mıknatıs içeren Çok Amaçlı Alet, implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı, örneğin göğüs cebinde taşınmamalıdır.

Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, mıknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

Koklear implantlar

Bir kulağınızda koklear implant (CI), diğerinde bir işitme cihazı kullanıyorsanız, CI anteninizi ve mıknatısları her zaman işitme cihazınızdan güvenli bir mesafede tuttuğunuzdan emin olun. CI mıknatıslarının manyetik alanı işitme cihazınızdaki hoparlör ünitesinde kalıcı hasara neden olabilir.

Örneğin, pilleri değiştirirken veya temizleme işlemi sırasında, kesinlikle cihazları masada bir araya koymayın. CI sistemi ile işitme cihazını aynı kutuda bir arada taşımayın.

X-ray/CT/MR/PET taramaları ve elektroterapi

Yüksek güçlü elektromanyetik alanlarda zarar görebileceklerinden, röntgen/CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarın.

İşitme cihazı asla aşırı ısıya maruz bırakılmamalı, örneğin güneşte park edilmiş bir araçta bırakmayın.

İşitme cihazı mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmamalı.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Devamı arka sayfada

Genel uyarılar

Çok güçlü cihaz

Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan, maksimum çıkış kapasitesinin 132 dB SPL'yi (IEC711) aşan bir işitme cihazının seçimi, uygulanması ve kullanımı sırasında özel bir özen gösterilmelidir.

Muhtemel yan etkiler

İşitme cihazları ve kulaklıklar kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazlarınızda kullanılan alerjik olmayan ürünler çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir.

Bu durumlar görülürse lütfen bir hekime başvurun.

Parazit

İşitme cihazı, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu testlere tabi tutulmuştur. Ancak işitme cihazınızda ve (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) diğer cihazlarda parazitler oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda işitme cihazınızı parazite neden olan aygıttan uzaklaştırın.

Uçakta kullanım

İşitme cihazınızda Bluetooth özelliği bulunur. Uçak personeli tarafından Bluetooth izni verilmediği sürece, uçaktayken uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir.

Harici ekipmana bağlantı

Harici ekipmana (yardımcı giriş kablosu ile, USB üzerinden veya doğrudan) bağlı olan bir işitme cihazının kullanım güvenliği, ilgili harici ekipman tarafından belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Uyumlu olmayan ve tedarik edilmeyen aksesuarlar

Sadece bu cihazın üreticisi tarafından sağlanan aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, emisyon değerlerinde artışa veya bağırsıklıkta azalmaya neden olabilir.

İşitme cihazlarında modifikasyona izin verilmez

Üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

Sorun Giderme

Belirti	Olası nedenleri	Çözümleri
Ses yok	Bitik pil	Pili değiştirin
	Kalıp tıkalı	Kalıbı temizleyin
	Mikrofonlar sessizde	Mikrofonları sessizden alın
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış	Kalıbı temizleyin
	Nem	Pili kuru bir bezle silin
	Bitik pil	Pili değiştirin
Ötme sesi	Kalıp yanlış takılmış	Kalıbı tekrar takın
	Kulak kanalında kir birikmiştir	Kulak muayenesi için doktorunuza gidin
	Kulakta büyüme	İşitme uzmanınızla irtibata geçin
Uyarı sesi geliyor/ turuncu ışık yanıp sönüyor (opsiyonel)	İşitme cihazınız 8 sinyal sesi çalışıyorsa, 4 kez ard arda ve/veya 4 kez ard arda küçük duraklamalarla turuncu ışık yanıp sönüyorsa, işitme cihazınızın servis tarafından mikrofon kontrolüne ihtiyacı vardır	İşitme uzmanınızla irtibata geçin
Apple cihazıyla eşleşme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız oldu	1) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın (Ayarlar→Genel→Erişilebilirlik→İşitme Cihazları→Cihazlar→Bu cihazı unut). 2) Bluetooth'u kapatıp tekrar açın. 3) İşitme cihazındaki pil yuvasını açın ve kapatın. 4) İşitme cihazını yeniden eşleştirin (bkz. bölüm: iPhone ile eşleştirme)
	Sadece bir işitme cihazı eşleşti	

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toza dayanıklı ve su girişine karşı korumalıdır, yani tüm günlük yaşam durumlarında kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu talimatlara uyun:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatlice silin
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazın kurumasını bekleyin
4. Yeni bir pil takın

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

Kullanım koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1°C ile +40°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25°C ile +60°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Teknik bilgi

Bu işitme cihazı, aşağıda açıklanan iki radyo teknolojisini içerir:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa menzilli manyetik indüksiyon teknolojisinin kullanıldığı radyo alıcı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan kuvveti oldukça zayıftır ve her zaman 15 nW değerinin altındadır (tipik olarak 10 metre mesafede -40 dBµA/m değerinin altında).

Bu işitme cihazı ayrıca her ikisi de ISM bandı 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir. Radyo vericisi zayıf ve toplam yayılma gücü her zaman 3 mW (4,8 dBm) değerindedir.

İşitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki "Teknik Veriler sayfası" nda bulabilirsiniz

Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



Üretici:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

CE 0543










Elektronik ekipmanlara ait atıklar, yerel kurallara göre atılmalıdır.

 **Bluetooth®**



IP68

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklamaları

	Uyarılar Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce okunmalıdır.
	Üretici Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT'de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	CE işareti Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET'ye uygundur. Dört basamaklı sayı, onaylı kuruluşun tanıdığını gösterir.
	Elektronik atık (WEEE) İşitme cihazlarını, aksesuarları veya pilleri yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık ve elektrikli ekipman (WEEE) hakkında 2012/19 / EU sayılı Direktif kapsamındaki elektronik ekipman.
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.
	IP kodu Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529'a uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.
	Bluetooth logosu Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.

Uygunluk için iPhone | iPad | iPod

Made for Apple işaretleri

Cihazın iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumlu olduğunu belirtir.



İşitme döngüsü

Bu logo, işitme desteği için evrensel sembolü içerir. "T" harfi ise bir işitme döngüsünün kurulu olduğunu ifade eder.

Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Dikkat işareti

Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlör, kulaklık, filtre vb. aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının uygun olmayan veya yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti, tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız,

bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için kendisine başvurun.

Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürün.

Garanti

Sertifika

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model sol: _____ Seri no: _____

Model sağ: _____ Seri no: _____

Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

İşitme cihazınız üzerinde yüklü olan ayarlar			
Sol		Sağ	
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Ses seviyesini değiştirme	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Programı değiştirme	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Sessiz	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Ses kontrol göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı sesleri	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Ses seviyesi değişikliklerinde sinyal sesi	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Açılış ses seviyesinde sinyal sesi	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
Pil göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Pil zayıf uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı

Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması			
<input type="checkbox"/>	Kullanım sınırlaması yoktur		
	Program	Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus)	Maks. ses seviyesi (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

Ses ve LED göstergeler

Farklı sesler ve LED ışıklar işitme cihazının durumunu gösterir. İlerleyen sayfalarda farklı göstergeler listelenmiştir.

İşitme uzmanınız ses ve LED göstergelerini tercihlerinize göre ayarlayabilir.










Program	<input type="checkbox"/> Ses	<input type="checkbox"/> LED ¹⁾	Ne zaman kullanılmalı
1	1 ton sesi	○	
2	2 ton sesi	○ ○	
3	3 ton sesi	○ ○ ○	
4	4 ton sesi	○ ○ ○ ○	




○ Yeşil renkte yanıp sönme

1) LED, sürekli veya kısa aralıklarla arka arkaya üç defa

AÇ/KAPAT	Ses	LED	LED yorumları
Açık	<input type="checkbox"/> Müzik sesi	<input type="checkbox"/> ○ ○	Bir defa gösterilir
Ses seviyesi	Ses	LED	
Açılış ses seviyesi	<input type="checkbox"/> 2 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> ○	Bir defa gösterilir
Minimum/maksimum ses seviyesi	<input type="checkbox"/> 3 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> ●	
Sesi artır/azalt	<input type="checkbox"/> 1 sinyal sesi	<input type="checkbox"/> ○	
Sessiz	<input type="checkbox"/> Azalan ton sesi	<input type="checkbox"/> ○ ●	Sürekli veya arka arkaya üç defa
Sessizden çıkart	<input type="checkbox"/> Artan ton sesi		












○ Yeşil renkte uzun yanıp sönme ○ Yeşil renkte yanıp sönme ● Turuncu renkte yanıp sönme

Aksesuarlar	<input type="checkbox"/> Ses	<input type="checkbox"/> LED	LED yorumları
FM ve kablosuz programlar ¹⁾	2 farklı ton sesi	 	Sürekli veya üç defa tekrar eden
FM ve kablosuz programlar ²⁾	2 farklı ton sesi	 	
Uçak modu	Ses	<input type="checkbox"/> LED	LED yorumları
Uçak modu aktif	Kısa müzik sesi	  	Sürekli veya üç defa tekrar eden
Uçak modu devre dışı	Kısa müzik sesi	  ³⁾	

 Yeşil renkte uzun yanıp sönme  Yeşil renkte yanıp sönme  Turuncu renkte yanıp sönme

- 1) DAI/FM + İşitme cihazı mikrofonu, TV Adaptörü
2) Sadece DAI/FM sinyali, ConnectClip uzak mikrofon
3) Yalnızca üç defa tekrarlama seçildiğinde kullanılabilir

208050TR / 2019.09.30

Uyarılar	Ses	LED	LED yorumları
Pil zayıf	<input type="checkbox"/> 3 farklı ton sesi	<input type="checkbox"/>       	Sürekli yanıp sönme
Pil tükendi	Azalan 4 ton sesi		
Mikrofon servis kontrolü gerekli	Arka arkaya 4 defa 8 uyarı sesi	<input type="checkbox"/>    	Arka arkaya dört defa

 Turuncu renkte yanıp sönme  Turuncu renkte uzun yanıp sönme

208050TR / 2019.09.30



oticon
PEOPLE FIRST